
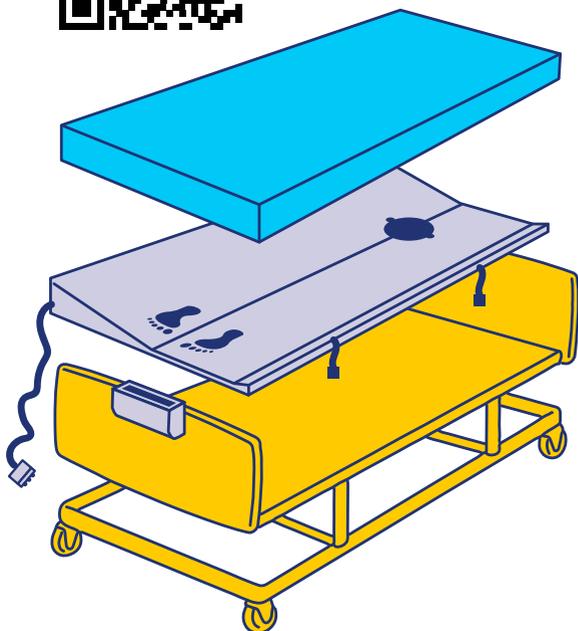


SCAN FOR
VIDEO 

Quick guides




turn all®

Système de retournement latéral automatisé 1C - 3C

Breveté



LEVABO®
medical

FR

Contenu du système Turn All®

1 pièce. Système de pompe Turn All® 1C
OU

1 pièce. Système de pompe Turn All® 3C

1 pièce. cordon d'alimentation au système de pompe

1 pièce. Matelas élévateur Turn All®

1 pièce. Housse Turn All® Le matelas élévateur est fourni pré-assemblé à l'intérieur de la housse

1 pièce. Mode d'emploi



À propos de l'utilisation et de l'installation du système

Ce mode d'emploi fournit des informations importantes sur l'utilisation du système Turn All®.

Veuillez lire les instructions avant d'essayer d'utiliser cet appareil.

Ces instructions d'utilisation font partie du produit et doivent être conservées à proximité du système afin qu'elles puissent être consultées à tout moment par le personnel et les opérateurs.

Si le système est transféré à un tiers, les instructions doivent l'accompagner.

Les illustrations de ces instructions sont destinées à fournir une démonstration claire de la situation actuelle et ne sont donc pas nécessairement à la bonne échelle, elles peuvent différer légèrement de la conception réelle de l'appareil.

Toutes les informations et tous les conseils contenus dans ce manuel ont été préparés conformément aux normes applicables.

Table des matières

Contenu du système Turn All®	2
À propos de l'utilisation et de l'installation du système	2
À propos du positionnement des patients et du système Turn All®	4
Fonction du système Turn All®	5
Installation du système Turn All®	6
Installer le système Turn All® sur un lit	6
Une information importante! Concernant le raccordement du tuyau	7
Démarrage et réglage du système Turn All®	8
Utilisation du système Turn All® pour le levage statique	9
Indications et contre-indications	10
Utilisations / emplacements autorisés	11
Sécurité	12
Dispositions relatives à la garantie et à la responsabilité	13
Nettoyage et désinfection	14
Notification d'événements accidentels	16
Données techniques	16
Approbations, normes et réglementations	17
Changer le filtre de la pompe	17
Gamme de produits Turn All®	18
Explication des symboles sur l'emballage	18
Déclaration de Conformité (CE)	18
Maintenance	19
Dépannage	19
FAQ	19
Des astuces	20

À propos du positionnement des patients et du système Turn All®

Les escarres sont des zones de la peau où la peau ou les tissus sous-jacents sont endommagés.

En cas d'immobilité et de risque de lésions cutanées, des escarres peuvent survenir en 10 à 15 minutes, c'est pourquoi un effort rapide et préventif est important. La plupart des escarres peuvent être évitées !

Les escarres peuvent survenir n'importe où sur le corps, mais les endroits du corps où les protubérances osseuses augmentent la pression contre le substrat sont particulièrement vulnérables. Il est donc important de se concentrer sur le soulagement de ces zones vulnérables dans la prévention des escarres.

Les personnes âgées et les patients alités sont particulièrement à risque de développer des escarres.

La paralysie, un mauvais état nutritionnel et des maladies telles que le diabète et l'athérosclérose augmentent également le risque d'escarres. À haut risque sont ceux qui sont incapables de changer ou de demander un changement de position pour eux-mêmes.

Il est donc important dans la prévention des escarres que les proches ou le personnel retournent fréquemment et soulagent les patients en position couchée et assise. Dans le même temps, il est important d'éviter les frottements contre le support qui peuvent entraîner un cisaillement (peau relâchée). Le besoin de soulagement et d'inversion est individuel, mais l'intervalle le plus fréquent pour l'inversion est de 1 ½ à 2 heures.

Le système Turn All® qui permet de retourner automatiquement le patient est d'une grande aide.

Le système libère des ressources pour les soignants, aidant ainsi à la fois le personnel et les patients.

Avantages du système Turn All

- Soulagement complet de la pression
- Prévention des escarres/ulcères
- Traitement des escarres / ulcères existants
- Confortable et n'interrompt pas le sommeil normal
- Silencieux lorsqu'il est utilisé
- Les patients bariatriques/lourds peuvent être retournés avec précaution et facilement, protégeant ainsi la santé et le bien-être du personnel travaillant avec eux
- Vue d'ensemble complète car le patient est toujours allongé sur le dos sur le matelas
- Positionnement en douceur même pour les patients douloureux
- Une légère butée du matelas, à l'opposé du côté de soulèvement, apporte soutien et réassurance et diminue le risque de cisaillement, voir figure page 5
- Le gain de temps se traduit par plus de temps de soins disponible pour le patient
- Amélioration du microclimat et de la circulation sanguine
- Robuste, durable et fiable
- Peut être intégré dans n'importe quel lit avec matelas amovibles.

Fonction du système Turn All®

Mode dynamique - Automatique

Le système Turn All® est un système de positionnement latéral automatique, pour le patient nécessitant une prévention ou un traitement des escarres.

Le positionnement s'effectue facilement et silencieusement. Le système prend env. 7-14 minutes pour un changement de position. En raison de ce changement de position très lent et régulier, le système est perçu comme très confortable par le patient.

Le système est basé sur un système de chambre à air qui soulève le patient couché alternativement sur les côtés droit et gauche.

Le système place ainsi le patient dans une position latérale à 30°, alternativement à droite et côté gauche.

Mode statique - Réglage manuel


En mode Statique, le système est utilisé comme un coussin incliné (sans automatisation), où la pente est contrôlée manuellement de 0 à 30°.

La pente est déterminée par la quantité d'air pompée dans le système.

Position latérale statique, comme un coussin.



L'illustration ci-dessous montre la séquence du positionnement automatique dans le système Turn All®.

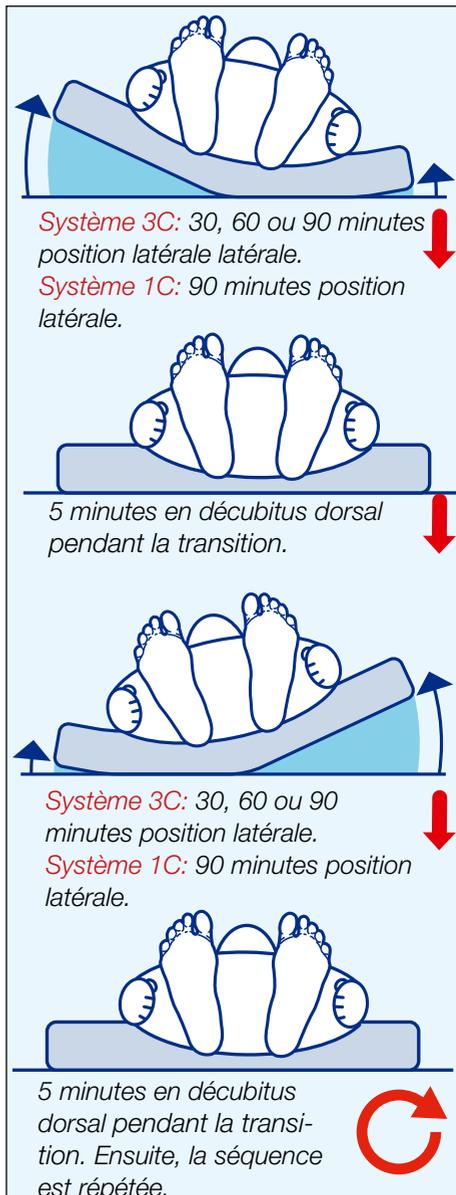

Installation du système Turn All®

Installer le système Turn All® sur un lit

Retirez le matelas du lit (Figure 1).




Placez le système Turn All® (A) sur le sommier, en orientant le système de sorte que le raccord du tuyau (B) se trouve au pied du lit (Figure 1.2).

Attachez le Turn All® aux parties articulées du sommier, en utilisant les sangles (H) sur la housse (Figure 1.2)

Remettez le matelas sur le lit au-dessus du système Turn All® (Figure 1.3).

La pompe Turn All® (C) est placée à l'extrémité du lit à l'aide des deux entretoises situées à l'arrière de la pompe (Figure 1) (Figure 1.3).

Insérez le raccord de tuyau (B) dans la pompe (C) (Figure 2) et (Figure 3) page 7.

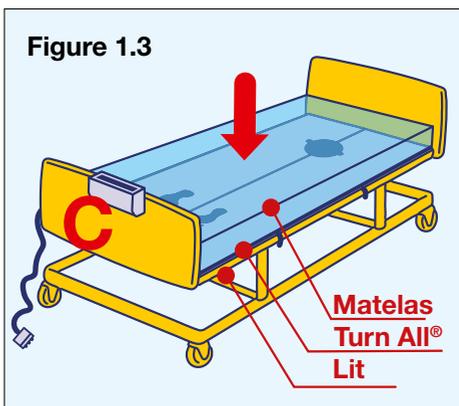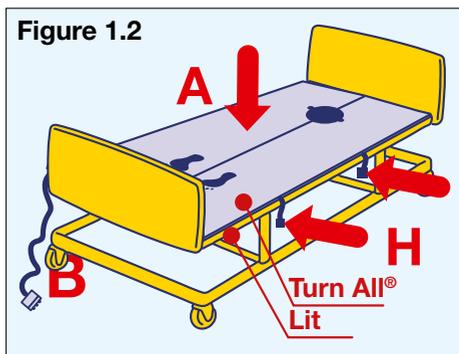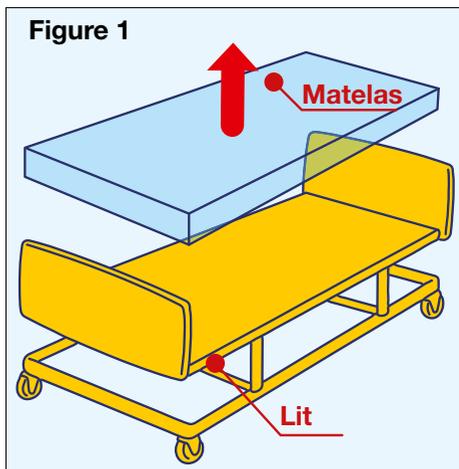

Une information importante! Concernant le raccordement du tuyau

Au démarrage du système:

L'orientation du raccord de tuyau (B) détermine quel côté du matelas est soulevé en premier.

Ceci est important si le système doit être utilisé pour le levage statique du patient d'un côté, comme un coussin incliné.

Voir la section « Utilisation du système Turn All® pour le levage statique » à la page 9.

Le raccord de tuyau (B) est marqué des lettres « R » à droite et « L » à gauche.



Si l'élévateur doit démarrer sur le côté droit du lit, vu depuis les pieds du patient, le raccord du tuyau avec

la lettre « R » est tournée vers le texte « Start side » sur la pompe, comme illustré à la (Figure 2).

Si l'élévateur doit démarrer sur le côté gauche du lit, vu depuis les pieds du patient, le raccord du tuyau avec la lettre « L » est tournée vers le texte « Start side » sur la pompe, comme illustré à la (Figure 3).

Après la première utilisation du système, le côté de démarrage sera arbitraire, mais si l'on souhaite changer le côté de levage, arrêtez la pompe pendant 3 secondes, après quoi le système change le côté de levage et continue avec le séquence de retournement.

Connectez le cordon d'alimentation à la pompe (figure 7)

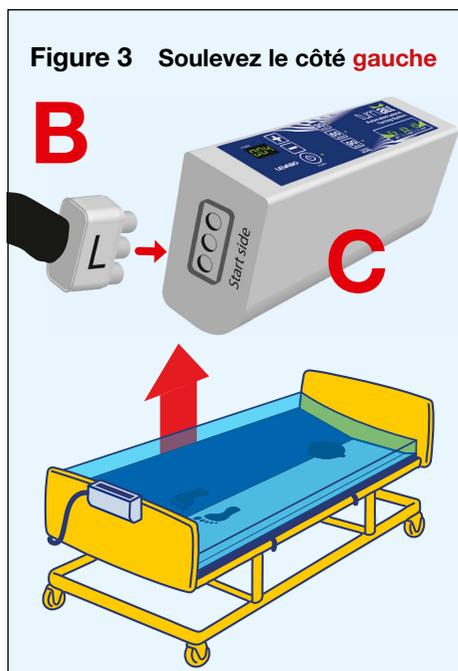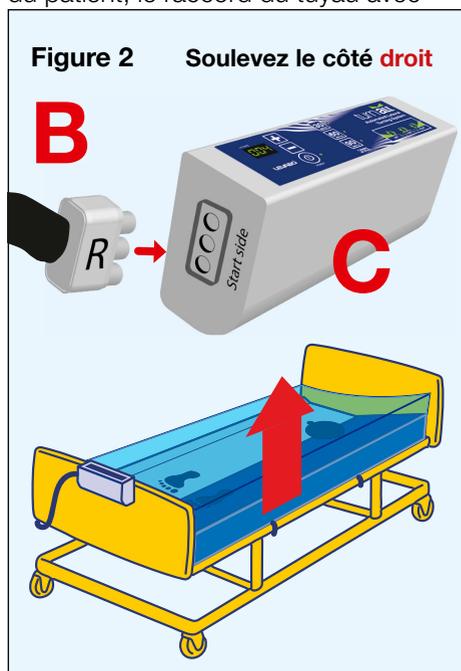

Démarrage et réglage du système Turn All®

Branchez le cordon d'alimentation au secteur.

Allumez la pompe avec le bouton « POWER » (D) (Figure 4).

Réglez la minuterie « G » avec les boutons « + » et « - ».

Le nombre dans la minuterie « G » indique combien d'heures le système doit fonctionner automatiquement.

Le système Turn All® fonctionne maintenant automatiquement. Un côté du matelas est maintenant soulevé pendant 30/60/90 minutes (système 1C 90 minutes), puis allongé à plat pendant 5 minutes pendant la transition, puis l'autre côté est soulevé


pendant 30/60/90 minutes (système 1C 90 minutes), puis allongé à plat pendant 5 minutes pendant la transition.

Cette séquence est répétée pendant le nombre d'heures réglé dans la minuterie « G », puis revient à plat. Voir l'illustration à la page 5.

IMPORTANT. Lorsqu'il n'est pas utilisé après un fonctionnement automatique, le système est éteint par le bouton POWER (D), puis par la prise secteur.

Débrancher le raccord de tuyau (B) de la pompe (C).

NE PAS installer le couvercle (E) sur le raccord de tuyau (B).

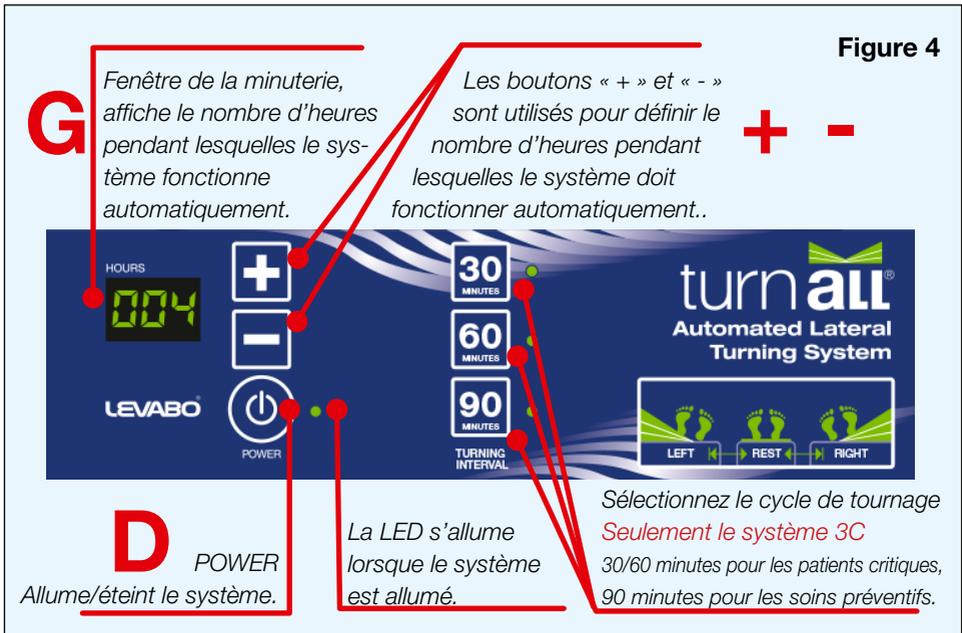

Utilisation du système Turn All® pour le levage statique

Si le système Turn All® doit être utilisé pour un levage statique en tant que coussin incliné, le raccordement du tuyau est inversé en fonction du côté qui doit être levé.

Voir la section « Important ! À propos du raccord de tuyau » page 7.

La pompe est démarrée et pompée jusqu'à ce que la hauteur de levage souhaitée soit atteinte.

Débranchez ensuite le raccord du tuyau (B) de la pompe (C) (Figure 5).

Le raccord de tuyau (B) est maintenant fermé avec le couvercle (E) (Figure 6). Lorsque le couvercle (E) est monté sur le raccord de tuyau (B), la pompe (C) est arrêtée par le bouton « POWER » (D).

Le système Turn All® restera maintenant dans cette position jusqu'à ce que le couvercle (E) soit à nouveau retiré et que l'air soit ainsi éliminé du système.

Assurez-vous que les chambres à air sont complètement vidées avant de rattacher le raccord de tuyau (B) à la pompe (C).

Figure 5

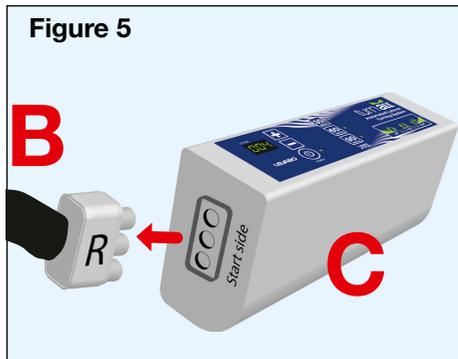


Figure 6


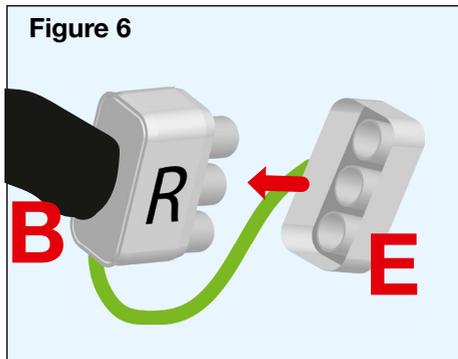


Figure 7

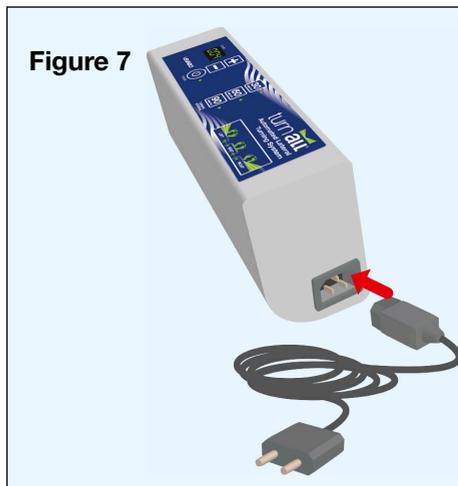

Indications et contre-indications

Indications / Objectif

Prévention et traitement des escarres.
Ulcères de pression existants et risque de développement d'escarres.
Risque d'escarre.

Le système Turn All® peut être utilisé dans des lits avec ou sans surfaces réglables.

Lorsque vous utilisez le système Turn All® dans des lits avec des surfaces réglables, assurez-vous de suivre les directives pour éviter le cisaillement.

Le système Turn® All convient à la prévention des escarres, y compris à tous les niveaux de risque de lésions cutanées.

Le produit peut être utilisé avec tous les grades d'escarres.

Cependant, il est important que la personne responsable du traitement soit consultée et que ses recommandations soient suivies.

Le système est conçu pour les patients pesant jusqu'à 225 kg.

Le système Turn All® est adapté et recommandé:

- Pour les personnes immobiles présentant un risque modéré à élevé d'escarres, selon l'échelle de Braden
- Pour les personnes dont le handicap ou la maladie les obligent à rester allongées pendant de longues périodes
- Pour les personnes qui ne peuvent pas changer de position eux-mêmes
- Pour les personnes qui ont souffert d'un accident vasculaire cérébral avec paralysie partielle
- Pour les blessés médullaires qui souhaitent changer de position quand allongés en utilisant leurs bras.



Contre-indications / Risques d'utilisation / Le produit ne peut pas être utilisé

Le système Turn All® ne peut pas être utilisé chez les patients présentant:

- Patients mobiles qui se retournent dans leur lit
- Fractures instables
- Brûlures graves.
- Troubles de l'équilibre
- Maladies neurologiques sous jacentes qui conduisent à un comportement anxieux chez les patients.

Utilisations / emplacements autorisés

Le système Turn All® peut être utilisé dans tous les lits avec matelas amovible.

Le système Turn All® peut être utilisé pour le même patient pendant une période prolongée.

Le système Turn All® est une aide à la prévention des escarres et une thérapie auxiliaire pour le traitement des escarres.

Même avec l'utilisation du système Turn All®, la peau doit être examinée régulièrement par des soignants et/ou du personnel médical qualifié connaissant les escarres

Noter! Les réclamations de toute nature pour des dommages résultant d'une utilisation impropre ou inappropriée sont exclues.

C'est l'utilisateur qui est seul responsable de tous les dommages en cas d'utilisation incorrecte ou inappropriée.

Sécurité



Cette section donne un aperçu des aspects importants de la sécurité, pour une protection optimale des patients et des soignants, ainsi qu'une utilisation sûre et sans problème du système.

Si le système Turn All® est utilisé dans un lit avec barrières de lit, la barrière de lit doit être de 220 mm plus haute que le matelas en position couchée.

Le système Turn All® est une aide pour la prévention des escarres et une thérapie auxiliaire pour le traitement des escarres.

Même avec l'utilisation du système Turn All®, la peau doit être examinée régulièrement par des soignants et/ou du personnel médical qualifié connaissant les escarres.

Noter! L'utilisateur est seul responsable de tous les dommages en cas d'utilisation incorrecte ou inappropriée.

Avis d'avertissement

Si la pompe doit être débranchée du secteur pendant le fonctionnement ou en cas de panne de courant, un signal d'avertissement sonore retentit pendant env. 5 minutes.

Le signal d'avertissement peut être fermé en appuyant sur la touche « POWER » (D) (Figure 4) page 8. Redémarrez ensuite le système.

L'emplacement de la pompe et l'emplacement du câble d'alimentation doivent être choisis de manière à exclure toute déconnexion involontaire du réseau d'alimentation. Le cordon d'alimentation doit être acheminé de manière à ne pas pouvoir être pincé ou écrasé. Il doit également être guidé de telle manière qu'il ne présente pas de risque de trébuchement.

Fonction CPR

En cas d'urgence médicale, un dégonflage rapide peut être nécessaire.

Pour ce faire, tirez sur la bande rouge marquée CPR pour l'ouvrir afin de ventiler les raccords des tuyaux vers le matelas.

Voir l'illustration ci-dessous.

En débranchant cette connexion, les chambres à air seront rapidement vidées et le lit reviendra en position horizontale.

Ce processus peut être encore accéléré en appuyant sur le matelas.

Assurez-vous que les chambres à air sont complètement vidées avant de rebrancher la connexion CPR.

Redémarrez ensuite le système.



Dispositions relatives à la garantie et à la responsabilité


Élévation du lit de soins

Le système soutient la position élevée du lit médicalisé dans les parties tête et pied. Cependant, il faut ici faire attention à la position et à la pose correctes du patient pris en charge. Cela dépendra de la forme du corps et du tableau clinique. En cas de doutes ou de questions, veuillez vous adresser au médecin traitant ou au prestataire de soins spécialisé.

Avec la tête du lit surélevée, il est important de s'assurer que le patient ne peut pas tomber vers l'avant.

Selon la forme du corps, un coussin de tête ne doit être utilisé que de manière appropriée.

L'élévation maximale de la tête du lit doit être de 20°-30°, mais si nécessaire, la tête du lit peut être plus haute pendant de courtes/longues périodes pour manger et boire.

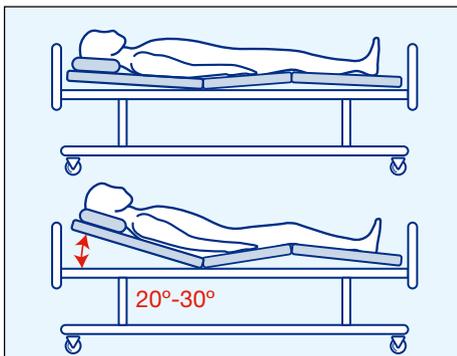

Lorsqu'il est utilisé correctement, Levabo ApS offre une garantie de 24 mois à compter de la date de facturation.

Pendant cette période, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées gratuitement en raison de défauts de fabrication.

Levabo ApS n'assume aucune responsabilité pour les dommages dus à :

- 1. Non-respect des instructions d'utilisation**
- 2. Utilisation non conforme à la notice**
- 3. Modifications non autorisées**
- 4. Modifications techniques**
- 5. Utilisation de pièces de rechange non autorisées.**

La garantie est basée sur des dispositions légales et des directives.

Si le système est modifié sans l'approbation préalable de Levabo ApS, la garantie expire.

Si il y a une réclamation sur la garantie et si, après vérification, il s'avère que ceux-ci reposent sur des signes d'usure ou d'autres types de dommages non couverts par la garantie, Levabo ApS est en droit de transférer les frais engagés (test, frais de transport, et autres) au client.

Nettoyage et désinfection

Nettoyage du système Turn All®

Turn All® Cover (la housse extérieure bleue)

Le matelas de levage interne doit être retiré de la housse Turn All® avant de laver la housse. voir page 15.

La housse Turn All® peut être lavée en machine à laver à 95°C et au sèche-linge à basse température.



Le couvercle Turn All® peut être nettoyé en autoclave v. Max. 121°C.

Le système Turn All® doit être débranché de la prise secteur avant le nettoyage.

Si le système Turn All® a été contaminé par des fluides corporels, il peut être nettoyé.

Le matelas intérieur Turn All® Multi Patient peut être nettoyé à l'eau tiède et au savon. La désinfection peut être effectuée avec une solution appropriée à base de chlore à 1%.

Le boîtier de commande Turn All® peut être vaporisé avec un désinfectant approprié ou avec de l'alcool/alcool propylique sur un chiffon humide pour l'essuyer.





Noter! N'utilisez pas de nettoyants caustiques ou abrasifs ou d'objets pointus pour nettoyer le système Turn All®.

Si le système Turn All® doit être nettoyé, vous pouvez retirer le matelas intérieur (H) figure 1, ouvrir la fermeture éclair (L) figure 1 et tirer les tubes de raccordement (B) figure 1-2) à travers l'ouverture dans la partie inférieure du couvercle.

Ouvrez la fermeture éclair (L) figure 1 et tirez les tubes de raccordement (B) figure 1-2) à travers l'ouverture dans la partie inférieure du couvercle.

Desserrez les 6 clips en plastique (K) Figure 3.

Le matelas intérieur (H) Figure 4, peut maintenant être retiré. Le matelas nettoyé est monté comme indiqué dans l'ordre inverse.

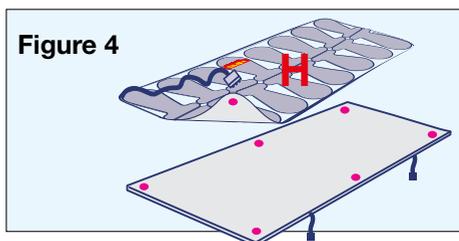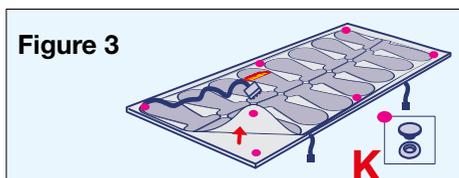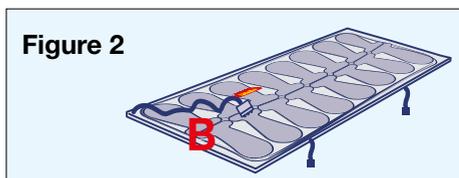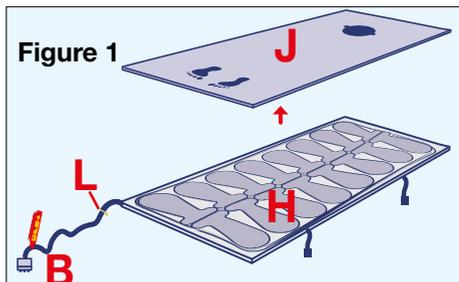

Notification d'événements accidentels

Les dysfonctionnements de l'appareil qui ont causé des blessures corporelles doivent être signalés immédiatement à l'autorité compétente et à la société Levabo ApS.

Noter! L'autorité compétente peut exiger que l'utilisateur soit informé de l'incident par un expert à ses frais et soumette l'évaluation par écrit. L'expert est choisi en accord avec l'autorité compétente.

L'évaluation technique de sécurité comprend les éléments suivants :

- À quoi l'événement peut-il être attribué
- Si le produit était en bon état
- S'il existe un autre danger après la réparation du dysfonctionnement
- Si de nouvelles connaissances ont été acquises, qui nécessitent d'autres ou des précautions supplémentaires.

Données techniques

Dimensions (L x L x H)

Couverture :200 x 85 x 15 cm

Matelas de levage :200 x 85 cm

Pompe :8 x 27 x 13,5 cm

Poids

Pompe :1,5 kg

Matelas avec housse :4 Kg

Angle de levage

Dynamique (automatique) : 30°

Statique (manuel) :0° - 30°

Données électriques

Tension secteur :240V

Fréquence :50 Hz / 60 Hz

Consommation électrique : .Max. 12 W

Classement :Classe II

Fusible :T500mA L250V

Stockage

-10° à 50° Celsius.

Humidité relative 0% à 95% sans condensation.

Conditions d'utilisation

Conçu pour un fonctionnement continu.

Température d'application :

0° à 40° Celsius.

Humidité relative 20% à 95% sans condensation.

Normes

Voir les approbations à la page 16.

Approbations, normes et réglementations

Partie supérieure de la couverture

Médical BI ELASTIQUE PES PU

Antibactérien et antifongique :
ISO 22196:2011 - **REUSSI**

Inflammabilité BS 7175 source d'allumage 5
Pré-traitement : Aucun
Méthode d'essai : BS 7175 : 1989 (2013)
Section 3 - **REUSSI**

Inflammabilité BS 7177 : 2008 + A1 : 2011
Risque faible
Méthode d'essai : BS EN 597-1 : 1995 &
BS EN 597-2 : 1995 - **REUSSI**

EN 1021-1-2 : - **REUSSI**

Partie inférieure de la couverture TPU

Noir ignifuge
Tissu dacron enduit de TPU 600D.

Antibactérien et antifongique :
ISO 22196:2011 - **REUSSI**

Inflammabilité BS 7175 source d'allumage 5
Pré-traitement : Aucun
Méthode d'essai : BS 7175 : 1989 (2013)
Section 3 - **REUSSI**

Inflammabilité BS 7177 : 2008 + A1 : 2011
Risque faible
Méthode d'essai : BS EN 597-1 : 1995 &
BS EN 597-2 : 1995 - **REUSSI**

EN 1021-1-2 : - **REUSSI**

Partie inférieure de la couverture PVC

Tissu dacron noir enduit PVC 600D.

Pompe


Testé et approuvé conformément à :
CEI 60601-1 : 2006 +A1 : 2013 :
Exigences générales pour la sécurité de
base et les performances essentielles.

Testé et approuvé conformément à :
EN60601-1-2 : 2007
Exigences générales pour la sécurité de
base et les performances essentielles,
Norme collatérale : Compatibilité
électromagnétique.

Testé et approuvé conformément à :
IEC 60601-1-11: 2015 (2. Edition) à
utiliser conjointement avec IEC 60601-
1:2012 (3. Edition) + A1: 2012
Exigences générales pour la sécurité de
base et les performances essentielles,
Norme collatérale : Exigences relatives
aux équipements électriques médicaux
et aux systèmes électriques médicaux
utilisés dans l'environnement des soins
de santé à domicile.

Changer le filtre de la pompe

1. À l'arrière de la pompe, il y a un couvercle.
2. Ouvrez le couvercle
3. À l'intérieur du couvercle se trouve le filtre, remplacez le filtre et montez dans l'ordre inverse.

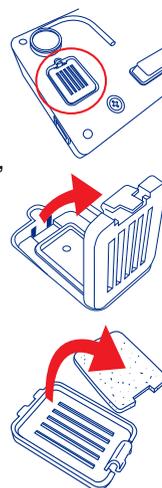

Gamme de produits Turn All®

Nom du produit	Taille en cm	Poids max en Kg	N° de produit	Application
Turn All multi-patient 3C avec couverture avec partie inférieure en TPU	85 x 200	225	70128	Système contenant matelas de levage Turn All®, 1 housse Turn All® avec/partie inférieure en TPU, et 1 pompe, 3 cycles 30/30, 60/60, 90/90 minutes
Couverture Turn All avec partie inférieure en TPU	85 x 200	NA	70114	Couverture pour matelas de levage Turn All® avec partie inférieure en TPU.
Pompe Turn All 3C	27 x 13 x 10	NA	76117	Pompe pour le système Turn All® 3 cycles
Bariatrique				
Turn All multi-patient 3C Bariatrique avec couverture avec partie inférieure en TPU	110 x 200	400	70098	Système Turn All® - TPU 3C multi-patients Ensemble de 1 matelas élévateur Turn All® monté dans la housse Turn All® et 1 pompe, 3 cycles 30/30, 60/60, 90/90 minutes
Couverture Turn All Bariatrique avec partie inférieure en TPU	110 x 200	N/A	70126	Turn All® Cover TPU Bariatrique Housse pour le matelas Turn All®.

Explication des symboles sur l'emballage

Explication des symboles sur l'emballage					
	Lire le mode d'emploi		Date d'expiration		Conformité Européenne
	Numéro de fabrication		Numéro de produit		Matériel dans l'emballage
	producteur		Date de fabrication		



Déclaration de Conformité (CE)

La société Levabo ApS, Sverigesvej 20A, 8660 Skanderborg, déclare que les produits sont conçus et fabriqués conformément à la documentation technique et aux exigences légales.

Produit

Turn All® est un produit médical actif selon :
Réglementation de l'UE MDR (UE) 2017/745, Dispositifs médicaux - Classe 1.

Production

EN ISO 9001: 2015 QMC
EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC

Maintenance

Matelas Turn All®

Le matelas doit être nettoyé régulièrement, voir nettoyage page 14

Pompe Turn All®

Le boîtier de commande Turn All® peut être nettoyé avec un désinfectant approprié ou avec de l'alcool/alcool propylique sur un chiffon humide pour essuyer.

Le filtre de la pompe doit être changé une fois par an, voir page 17

Dépannage

La pompe ne démarre pas

Vérifiez que le cordon est correctement branché sur la pompe et que la prise de courant est allumée

Le matelas ne se soulève pas mais la pompe fonctionne

Vérifier que le raccord de tuyau est correctement connecté à la pompe
Vérifiez que l'évent CPR est correctement fermé

La pompe ne pompe pas comme prévu

Éteignez la pompe, débranchez-la, attendez 10 minutes.
Branchez la pompe sur la prise de courant et allumez la pompe

FAQ

De quel lit ai-je besoin pour installer le système Turn All® ?

Le système Turn All® peut être intégré dans un lit standard avec un matelas amovible.

Comment nettoyer le système Turn All® ?

La housse Turn All® (la housse bleue) est lavable et peut être lavée en machine à 90°C et passe au sèche-linge à basse température. Remarque : le matelas de levage intérieur n'est pas lavable en machine, il peut être lavé à l'eau tiède et au savon.

La désinfection peut être effectuée avec une solution appropriée à base de chlore à 1% sur un chiffon humide pour essuyer.

Quelles sont les dimensions de Turn All® ?

(L x l x H)
Couverture : 200 x 85 x 15 cm
Matelas de levage : 200 x 85 cm
Pompe : 8 x 27 x 13,5 cm

Combien pèse Turn All® ?

Pompe : 1,5kg
Matelas avec housse : 4kg

Quel est le poids maximum de l'utilisateur pour Turn All® ?

Le système est conçu pour les utilisateurs pesant jusqu'à 225 kg.

Des astuces

Changer de côté de levage

Si la pompe monte du côté opposé à ce que vous voulez, éteignez la pompe, attendez quelques secondes, rallumez la pompe et elle se soulèvera du côté opposé.

Toilette au lit

Lors du lavage des patients alités, Turn All® peut être d'une grande aide pour placer le patient dans une position latérale à 90° pour le lavage et l'hygiène personnelle.

DISTRIBUTION FRANCE : CREE SAS

Contact : cree@cree.fr
www.cree.fr



Service d'assistance en ligne :

0 899 493 251

**Service 0,60 €/min
+ prix appel**

LEVABO[®]
medical

www.levabo.com
www.facebook.com/LevaboAps

Levabo ApS
Sverigesvej 20
8660 Skanderborg DK